

Inicio del tratamiento

Esta ficha de procedimiento no intenta reemplazar el asesoramiento o la capacitación brindados por su médico o enfermera de DP. Consulte la Guía del usuario de la cicladora Liberty PDX (P/N 480054-01) para obtener información detallada sobre la descripción del dispositivo, instrucciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Con éste y todos los demás procedimientos de diálisis peritoneal, siempre mantenga la técnica de esterilización. Esta información se brinda únicamente a modo de referencia rápida. Siga las instrucciones como aparecen en las pantallas de la cicladora Liberty. Espere sus indicaciones para ir al paso siguiente.


Nota: Todas las ilustraciones son solo a modo de ejemplo.

1



- Asegúrese de que la cicladora esté enchufada en un tomacorriente con descarga a tierra.
- Si usa el sistema IQdrive™, insértelo en el puerto USB que se encuentra en la parte posterior izquierda de la cicladora Liberty PDX si se está frente a la parte delantera de la cicladora.
- Encienda la cicladora Liberty con el interruptor de encendido blanco que se encuentra en la parte posterior.

2

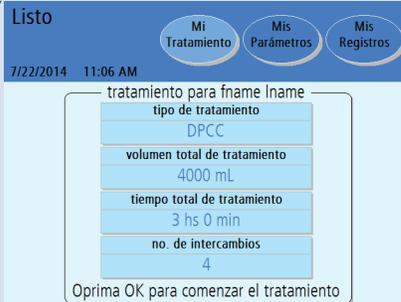


- Para hacer cambios en la terapia, paciente, opciones o elecciones de hardware, presione ahora en **Mis Parámetros**.
- Regrese a la pantalla Listo y asegúrese de que la información de la receta sea correcta.
- Presione OK para comenzar el tratamiento.

3




- Reúna los artículos necesarios:
 - Bolsas de solución (verifique la solución, la claridad, la cantidad, las fugas, y la fecha de expiración.)
 - Casete de la cicladora Liberty PDX
 - Organizador stay*safe
 - Tapas de stay*safe
 - Línea(s) o bolsas de drenaje
 - Desinfectante para manos
- Póngase una máscara y lávese las manos.

4

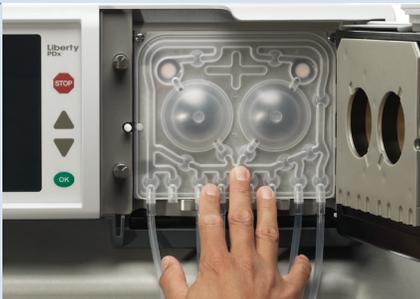

- Antes de realizar la inserción, inspeccione los tubos del cassette y la película para verificar que no haya daños.
- Primero, inserte cuidadosamente la parte superior del cassette, luego presione la parte inferior hasta que encaje y cierre la puerta.
- Las líneas deben colgar hacia abajo.
- Inserte el conector (gatillo) de la línea del paciente (la línea de la pinza azul) en el organizador stay*safe.
- Presione **Sigue**.

5

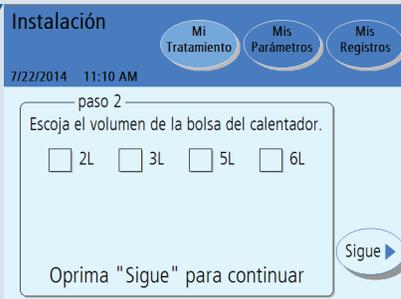

Cuando se indique:

- Elija el volumen de la bolsa del calentador:
 - 2L, 3L, 5L o 6L.
- La bolsa que usa para su bolsa del calentador debe tener por lo menos 1000mL más que el primer volumen a infundir y por lo menos tanto como el máximo volumen a infundir.

6



Cuando se indique:


- Conecte la línea de color **ROJO** a la bolsa del calentador.
- Conecte la línea de color **VERDE** a la última opción de bolsa o una bolsa de suministro adicional.
- Conecte las líneas de color **BLANCO** a las bolsas de suministro adicionales.
- Conecte la línea de color **AMARILLO** a la línea o bolsas de drenaje.
- Asegúrese de que la bolsa del calentador esté colocada uniformemente en la bandeja del calentador.
- Presione **Sigue**.

Inicio del tratamiento (continuación)




Cuando se indique:


- Rompa los conos del calentador y las bolsas de la solución con los dedos o con una herramienta stay*safe.
- Doble el cono hacia atrás y hacia adelante hasta que se separe por completo y los conos floten.
- Sujete con pinza las líneas que no se usen.
- Presione **Sigue**.

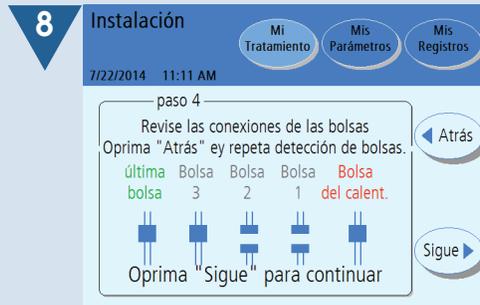

- Verificación de detección de las bolsas muestra cuales líneas están conectadas a las bolsas de solución.
- Las bolsas conectadas tienen líneas sin pinza. Las bolsas no conectadas tienen líneas con pinza.
- Verifique que sus bolsas coincidan con las de la pantalla.
- Presione **Sigue**.

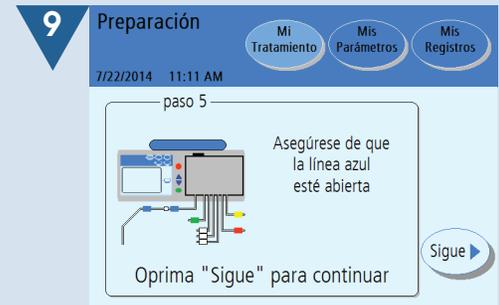


- Verifique que la pinza azul de la línea del paciente esté abierta.
- Presione **Sigue** para cebar la línea del paciente (la línea de la pinza azul).

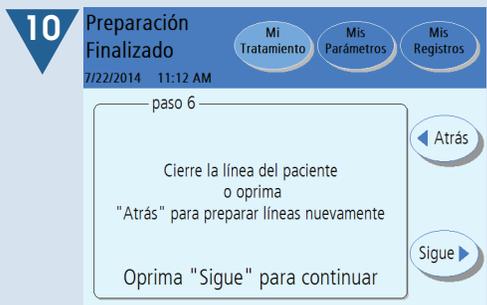

- Una vez finalizado el cebado, inspeccione la línea de la pinza azul para el paciente con el fin de verificar que esté completamente llena de líquido.
- Presione **Atrás** para volver a cebar según sea necesario.
- Cierre la pinza azul de la línea del paciente y presione **Sigue**.



- Ingrese **Sí** si llenó el abdomen con solución sin usar la cicladora Liberty PDX (intercambio manual).
- Ingrese el volumen a infundir de su intercambio manual. Presione **Sigue** para continuar.
- Revise las configuraciones ingresadas y luego presione **Sigue** nuevamente.

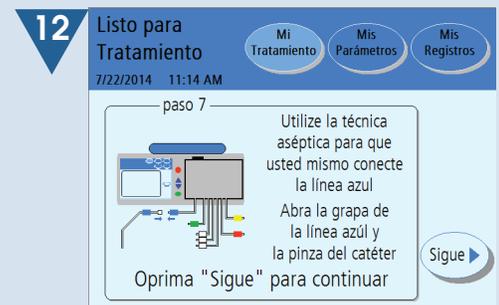

- Una vez conectado, abra ambas pinzas, la pinza del catéter y la pinza azul para el paciente.
- Presione **Sigue** para continuar.
- El tratamiento comenzará en este momento.



Indicaciones de uso: La cicladora Liberty PDX de Fresenius Medical Care ha sido diseñado para diálisis peritoneal aguda y crónica.

Precaución: La legislación federal (estadounidense) establece que este dispositivo solo puede ser vendido por un médico o por orden de un médico.

Fabricado por:
Fresenius USA, Inc.
4040 Nelson Ave
Concord, CA 94520

Para hacer preguntas o consultas, comuníquese a cualquier hora con el servicio técnico al 1-800-227-2572. Fresenius Medical Care, el logotipo del triángulo, staysafe, IQdrive y Liberty son marcas comerciales de Fresenius Medical Care Holdings, Inc. y/o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. © 2007-2014 Fresenius Medical Care North America. Todos los derechos reservados. P/N 480055-01 Rev A 09/2014