



NEU

### Datenerfassung: vom Quer- zum Längsschnitt

Die am 01.01.2014 in Kraft tretende Änderung der Qualitätssicherungs-Richtlinie Dialyse (QSD-RL) ist im Hinblick auf zukünftige Längsschnitt-Datenerfassung überarbeitet worden.

Die zu erfassenden **Parameter** sowie der **Datenfluss** haben sich geändert. Letzterer wird im Hintergrund über Ihre Praxissoftware und Ihre EuCliD® Schnittstelle angepasst, so dass sich der Arbeitsvorgang für Sie nicht ändert. Fresenius Medical Care steht Ihnen mit dem EuCliD® Service weiterhin als offizieller Berichtsteller zur Verfügung.

Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Sicherung der Qualität von Dialyse-Behandlungen nach den §§ 136 und 137 Abs. 1 Nr. 1 des Fünften Sozialgesetzbuches (SGB V) (BAnz AT 06.11.2013 B1)

### Was bleibt bestehen?

Nach wie vor bleiben die zwei Regelbereiche nach QSD-RL erhalten:

#### 1. Das zentrale Verfahren (Datenanalyst):

Stichprobenprüfungen gem. § 136 Abs. 2 Satz 2 SGB V (QSD-RL Anlage 2 und 3)

- ▶ Auffälligkeitsprüfung mit dem Ziel der Qualitätsbeurteilung

#### 2. Das dezentrale Verfahren (Berichtsteller):

verpflichtende Teilnahme an einrichtungsübergreifenden Qualitätssicherungsmaßnahmen gem. § 137 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 135 a Abs. 2 Nr. 1 SGB V (QSD-RL Anlage 4 und 7)

- ▶ Benchmarkverfahren mit dem Ziel, das einrichtungsinterne Qualitätsmanagement zu unterstützen und den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in Jahresberichten über das Versorgungsgeschehen zu informieren.

### Was ist neu? ...

### Das ist neu

#### Patientenbezogene Parameter

**NEU:** Die klinischen Parameter der Auffälligkeitsprüfung und des Benchmarkverfahrens können patientenbezogen zusammengefasst und beurteilt werden. Eine am Behandlungsverlauf der Patienten orientierte Qualitätssicherung ist somit möglich.

#### Datenübertragung und Pseudonymisierung

**NEU:** Pseudonymisierung durch die Vertrauensstelle.

Die Daten zur Stichprobenprüfung (Basisblockdaten) werden wie zuvor zusammen mit Ihrer Abrechnung verschlüsselt an die zuständige KV übertragen und von dort über die Vertrauensstelle einrichtungs- und patientenpseudonym an den Datenanalysten weitergeleitet.

**NEU:** In einem separaten Datensatz werden die Daten zum einrichtungsübergreifenden Benchmarking (Zusatzdaten) zusammen mit den Daten zur Stichprobenprüfung ebenfalls verschlüsselt an die KV übertragen und von dort über eine Vertrauensstelle patientenpseudonym an den Berichtersteller weitergeleitet.

Einmal im Jahr werden Ihre Daten vom Berichtersteller an den Datenanalysten zur Erstellung eines Jahresberichts übermittelt.

**NEU:** Der Datenanalyst kann nun anhand des von der Vertrauensstelle vergebenen Patientenpseudonyms die Daten aus der Stichprobenprüfung und dem einrichtungsübergreifenden Benchmarking zusammenführen.


**NEU:** Der G-BA legt den Zeitpunkt und die Ziele einer möglichen Evaluation unter Berücksichtigung der Empfehlung einer Dialyse-Fachgruppe fest. Die erste Evaluation soll zwei Jahre nach Inkrafttreten der RL-Änderung erfolgen.

**NEU:** Die sekundäre Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen Zwecken ist auf Antragstellung über den Datenanalysten an den G-BA möglich.




## Die zu erfassenden Parameter ändern sich

**Zentrale Auswertung** (Datenanalyst): Auffälligkeitskriterien für Stichprobenprüfung (QSD-RL Anlage 3)

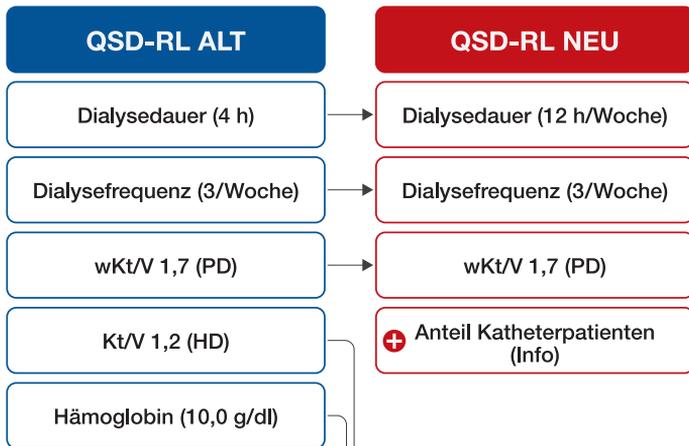

*Auffälligkeit einer Dialyseeinrichtung, wenn über 15% der Patienten den Grenzwert überschreiten (Ausnahme: Anteil Katheterpatienten)*

**Dezentrale Auswertung** (Berichtersteller): einrichtungübergreifende Qualitätssicherungsmaßnahmen (Benchmark) (QSD-RL Anlage 4)

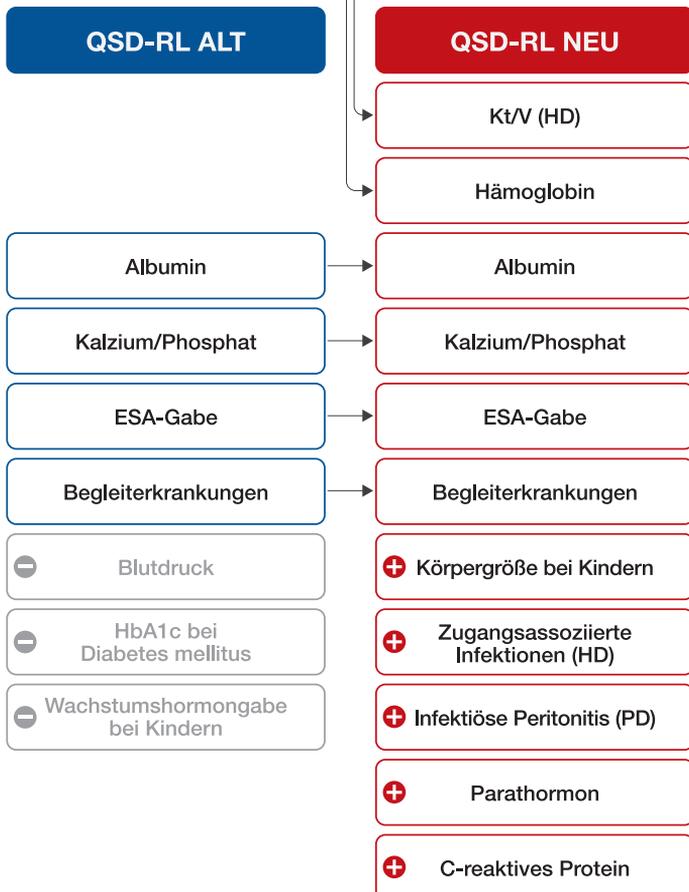

## ... und das bleibt

- **Fresenius Medical Care mit dem EuClID® Service als Berichtersteller**
- **Nutzung der EuClID® Schnittstelle zu Nephro7 und IndiCation**
- **Quartalsweise Datenübertragung**
- **KV-Quartalsberichte vom Berichtersteller für Sie**
- **Erweitertes Benchmarking und entsprechende Berichte**



**FRESENIUS  
MEDICAL CARE**

Firmensitz: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Deutschland  
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-2191

Deutschland: Fresenius Medical Care GmbH · Else-Kröner-Straße 1 · 61352 Bad Homburg v. d. H.  
Telefon: +49 (0) 6172-609-0 · Fax: +49 (0) 6172-609-8740 · E-mail: [marketing.deutschland@fmc-ag.com](mailto:marketing.deutschland@fmc-ag.com)

[www.fmc-deutschland.com](http://www.fmc-deutschland.com)